



HT20-A 砂浆回弹仪

产品使用说明书



请先阅读

感谢您选择济南朗睿检测技术有限公司的产品，我公司将竭诚为您提供优质的产品和快捷的售后服务。在使用我公司产品之前请您务必仔细阅读本说明书中的内容。

1、说明书在编制过程中力求对所包含内容及数据进行正确而又完整的描述，但并不保证其中无任何错误或遗漏，对此所导致的任何后果恕不承担任何责任。

2、济南朗睿检测技术有限公司保留随时更改说明书内容而毋须事先声明的权利，恕不另行通知。

3、济南朗睿检测技术有限公司对本仪器及相关故障导致数据偏差或不正确的检测结论，由此带来的可能损失，恕不承担任何责任。

4、本仪器已经使用，即意味着您已经全部阅读、准确理解了本说明中的全部条款，并且您已经完全同意本说明中所有条款。

5、在非济南朗睿检测技术有限公司直接参与的销售及服务过程中，所签订有违背于本声明的协议内容，济南朗睿检测技术有限公司不承担任何责任。

目 录

第一章 概述.....	1
第二章 回弹仪的结构.....	3
第三章 回弹仪的操作保养及校验.....	4
第四章 检测及数据整理.....	6
第五章 混凝土强度的计算.....	10
附录A 软件获取.....	14
附录B 仪器维修与故障排除、保养维护指南.....	15

第一章 概 述

1.1概述

砂浆回弹仪的工作原理是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击砂浆表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力，使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离，以此作为评定砂浆抗压强度相关的指标之一，来推定烧结普通砖或烧结多孔砖砌体中砌筑砂浆的强度。不适用于推定高温、长期浸水、遭受火灾、环境侵蚀等砌筑砂浆的强度。

本公司生产的HT20-A砂浆回弹仪系冲击动能为0.196J，示值系统为指针直读式。

1.2主要技术指标

- 1、冲击动能：0.196J
- 2、弹击拉簧拉伸长度： $75\pm0.3\text{mm}$
- 3、指针滑块的摩擦力： $0.5\pm0.1\text{N}$

- 4、弹击拉簧工作长度: 61.5 ± 0.3 mm
- 5、弹击锤脱钩位置: 刻度尺 “100” 刻线
- 6、弹击杆端部球面半径: 25 ± 1 mm
- 7、弹击锤起跳位置: 刻度尺 “0~1” 处
- 8、钢钻上的率定值: 74 ± 2

第二章 回弹仪的结构

2.1 回弹仪构造和主要零件名称

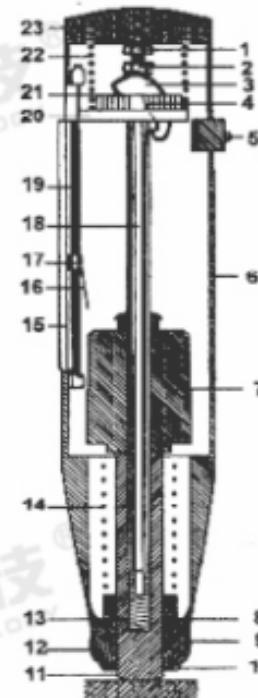


图2-1

- | | | |
|----------|---------|---------|
| 1—紧固螺母 | 2—调零螺钉 | 3—挂钩 |
| 4—挂钩销子 | 5—按钮 | 6—机壳 |
| 7—弹击锤 | 8—拉簧座 | 9—卡环 |
| 10—防尘密封圈 | 11—弹击杆 | 12—盖帽 |
| 13—缓冲压簧 | 14—弹击拉簧 | 15—刻度尺 |
| 16—指针片 | 17—指针块 | 18—中心导杆 |
| 19—指针轴 | 20—导向法兰 | 21—挂钩压簧 |
| 22—压簧 | 23—尾盖 | |

第三章 回弹仪的操作、保养及校验

3.1操作

- 1)、将弹击杆顶住砂浆的表面，轻压仪器，使按钮松开，放松压力时弹击杆伸出，挂钩挂上弹击锤。
- 2)、使仪器的轴线始终垂直于砂浆的表面并缓慢均匀施压，待弹击锤脱钩冲击弹击杆后，弹击锤回弹并带动指针向后移动至某一位置时，指针块上的示值刻线在刻度尺上指示出一定数值即为回弹值。
- 3)、使仪器机芯继续顶住砂浆表面进行读数并记录回弹值。如条件不利于读数，可按下按钮，锁住机芯，将仪器移至它处读数。
- 4)、逐渐对仪器减压，快速复位使弹击杆自仪器内伸出，待下一次使用。
- 5)、回弹仪使用完毕，应使弹击杆伸出机壳，并应清除弹击杆、杆前端球面以及刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时，应将弹击杆压入机壳内，经弹击后应按下按钮，锁住机芯，然后装入仪器箱。仪器箱应平放在干燥阴凉处。

3.2保养

回弹仪有下列情况之一时应进行常规保养；

- 1)、弹击超过2000次；
- 2)、对检测值有怀疑时；
- 3)、钢砧率定值不合格。

常规保养方法应符合下列要求：

- 1)、放松弹击杆使弹击杆处于伸出状态。使弹击锤脱钩后取出机芯，然后卸下弹击杆（取出里面的缓冲压簧）和三联件（弹击锤、弹击拉簧和拉簧座）；
- 2)、用煤油清洗机芯各零部件，特别是中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表油（或缝纫机油、变压器油），其它零部件均不得涂油；
- 3)、清理机壳内壁，卸下刻度尺，检查指针磨擦力，应为 $0.5\pm0.1\text{N}$ 之间；
- 4)、不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝；
- 5)、不得自制或更换零部件；
- 6)、保养后应按要求进行率定试验，率定值应为 74 ± 2 。

3.3检定

回弹仪有下列情况之一时应送法定部门检定，检定合格的回弹仪应具有检定证书：

- 1)、新回弹仪启用前；
- 2)、超过检定有效期限（有效期为半年）；
- 3)、经常规保养后钢砧率定值不合格；
- 4)、遭受严重撞击或其他损害。

3.4检定条件

- 1)、回弹仪率定试验应在室温为（5~35）°C的条件下进行；
- 2)、钢砧表面应干燥、清洁，砧体稳固地平放在刚度大的物体上；
- 3)、回弹值应取连续向下弹击三次的稳定回弹值的平均值。率定应分四个方向进行，弹击杆每次应旋转90度，弹击杆每旋转一次所测得的三次率定平均值均应为 74 ± 2 ；
- 4)、率定回弹仪的钢砧应每2年送授权计量检定机构检定或校准。

第四章 检测及数据整理

4.1一般规定

- 1、检测时，应用回弹仪测试砂浆表面硬度，并应用浓度为1%-2%的酚酞酒精溶液测试砂浆碳化深度，应

以回弹值和碳化深度两项指标换算为砂浆强度。

2、检测前，应宏观检查砌筑砂浆质量，水平灰缝内部的砂浆与其表面的砂浆质量应基本一致。

3、测位宜选在承重墙的可测面上，并应避开门窗洞口及预埋件等附近的墙体。墙面上每个测位的面积宜大于 $0.3m^2$ 。

4、墙体水平灰缝砌筑不饱满或表面粗糙且无法磨平时，不得采用砂浆回弹法检测砂浆强度。

4.2 测试步骤

1、测位处应按下列要求进行处理：

1)、粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清除干净。

2)、弹击点处的砂浆表面，应仔细打磨平整，并应除去浮灰。

3)、磨掉表面砂浆的深度应为 $5mm-10mm$,且不应小于 $5mm$ 。

2、每个测位内应均匀布置12个弹击点。选定弹击点应避开砖的边缘、灰缝中的气孔或松动的砂浆。相邻两弹击点的间距不应小于 $20mm$ 。

3、在每个弹击点上，应使用回弹仪连续弹击3次，第1、2次不应读数，应仅记读第3次回弹值，回弹值读数

应估读至1。测试过程中，回弹仪应始终处于水平状态，其轴线应垂直于砂浆表面，且不得移位。

4、在每一测位内，应选择3处灰缝，并应采用工具在测区表面大凿出直径约为10mm的孔洞，其深度应大于砌筑砂浆的碳化深度，应清除孔洞中的粉末和碎屑，且不得用水擦洗，然后采用浓度为1%-2%的酚酞酒精溶液喷洒在孔洞内壁边缘处，当已碳化与未碳化界限清晰时，应采用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化砂浆交界面到灰缝表面的垂直距离。

4.3数据分析

1)、从每个测位的12个回弹值中，应分别剔除最大值、最小值，将余下的10个回弹值计算算术平均值，应以R表示，并应精确至0.1。

2)、每个测位的平均碳化深度，应取该测位各次测量值的算术平均值，应以d表示，并应精确至0.5mm。

3)、在第*i*个测区第*j*个测位的砂浆强度换算值，应根据该测位的平均回弹值和平均碳化深度值，分别按下列公式计算：

$d \leq 1.0\text{mm}$ 时：

$$f_{2ij} = 13.97 \times 10^{-5} R^{3.57}$$

$1.0\text{mm} < d < 3.0\text{mm}$ 时:

$$f_{2ij} = 4.85 \times 10^{-4} R^{3.04}$$

$d \geq 3.0\text{mm}$ 时:

$$f_{2ij} = 6.34 \times 10^{-5} R^{3.60}$$

式中:

f_{2ij} 第 i 个测区第 j 个测位的砂浆强度值 (MPa) ;

d 第 i 个测区第 j 个测位的平均碳化深度 (mm) ;

R 第 i 个测区第 j 个测位的平均回弹值。

4、测区的砂浆抗压强度平均值，应按下式计算：

$$f_{2i} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} f_{2ij}$$

第五章 强度推定

5.1 检测数据中的岐离值和统计离群值，应按现行国家标准《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》GB/T4883中的有关格拉布斯检验法或狄克逊检验法检出和剔除。检出水平 α 应该取0.05，剔除水平 α 应取0.01；不得随意舍去岐离值，从技术或物理上找到产生离群原因时，应予剔除；未找到技术或物理上的原因时，则不应剔除。

5.2 根据国家标准《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2011）的各种检验方法，应给出每个测点的检测强度值，以及每一个测区的强度平均值，并应以测区强度平均值作为代表值。

5.3 每一检测单元的强度平均值、标准差和变异系数，应按下列公式计算：

$$\bar{x} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} f_i$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_2} (\bar{x} - f_i)^2}{n_2 - 1}}$$

$$\delta = \frac{s}{\bar{x}}$$

式中： \bar{x} 同一检测单元的强度平均值（MPa）。当检测砂浆抗压强度时， \bar{x} 即为 $f_{2,m}$ 。

n 同一检测单元的测区数；

f_i 测区的强度代表值（MPa）。当检测砂浆抗压强度时， \bar{x} 即为 $f_{2,i}$

s 同一检测单元，按 n_2 个测区计算的强度标准差（MPa）；

δ 同一检测单元的强度变异系数

5.4 对在建或新建砌体工程，当需推定砌筑砂浆抗压强度值时，可按下列表公式计算：

5.4.1 当测区数 n_2 不小于6时，应取下列公式中的较小值：

$$f'_2 = 0.91f_{2,m}$$

$$f'_2 = 1.18f_{2,min}$$

式中： f'_2 砌体砂浆抗压强度推定值（MPa）；

$f_{2,min}$ 同一检测单元，测区砂浆抗压强度的最小值（MPa）。

5.4.2 当测区数 n_2 小于6时，可按下列表公式计算：

$$f_2' = f_{2,min}$$

5.5 对既有砌体工程，当需推定砌筑砂浆抗压强度值时，应符合下列要求：

a. 按国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002及之前实施的砌体工程施工质量验收规范的有关规定修建时，应按下列公式计算：

1) 、当测区数 n_2 不小于6时，应取下列公式中的较小值：

$$\begin{aligned}f_2' &= f_{2,m} \\f_2' &= 1.33f_{2,min}\end{aligned}$$

2) 、当测区数 n_2 小于6时，可按下列公式计算：

$$f_2' = f_{2,min}$$

b. 按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011的有关规定修建时，可按本说明书的第五章第4条的规定推定砌筑砂浆强度值。

- 6、当砌筑砂浆强度检测结果小于2.0MPa或大于15MPa时，不宜给出具体检测值，可仅给出检测值范围
 $f_2 < 2.0\text{ MPa}$ 或 $f_2 > 15\text{ MPa}$ 。
- 7、砌筑砂浆强度的推定值，宜相当于被测墙体所用块体作底模的同龄期、同条件养护的砂浆试块强度。
- 8、砌筑砂浆强度检测的最终计算或推定结果，应精确至0.1MPa。

附录A 软件获取

- 1、扫描右侧二维码关注微信公众号，点击下方【软件下载】，下载【回弹小助手】。
- 2、点击【手动输入】，输入对应回弹值，选择检测面、检测依据等项目，可以自动计算出强度结果。



扫码关注 朗睿科技

附录B 仪器维修与故障排除、保养维护指南

请扫描下方二维码，关注【小睿学堂】，了解学习更多仪器使用维护与保养相关视频



扫描关注 小睿学堂

版本：V1.3



关注朗睿 获取更多技术支持

济南朗睿检测技术有限公司

热线:400-117-5168 网址:www.jnlrkj.com