




Σ0-0011X-SN

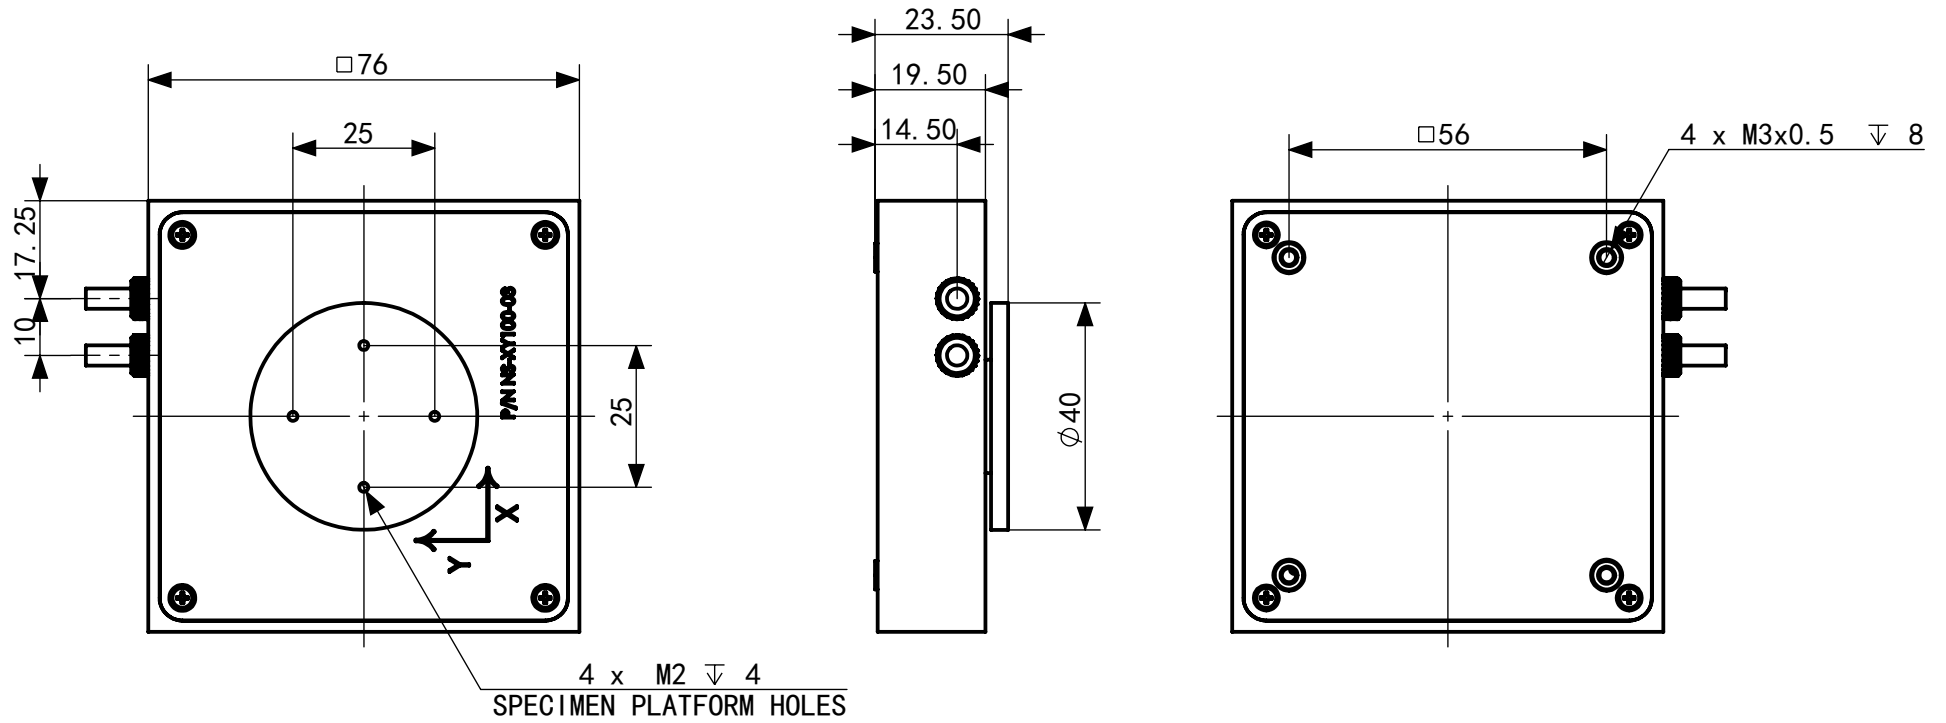

 三英精控(天津)仪器设备有限公司		NS-XY100-03		版本号		
		计算机文件名				
设计			数量	质量	比例	图幅
绘图						A4
审核			第 张	共 张		
审核			名称紧凑型XY二维纳米定位台			
会签			材料			
审定			 传真: 022-29516023 电话: 022-22977677			
批准						